Dexcom | G5 mobile

연속적인 포도당 모니터링 시스템

시작하기 가이드

사용 지침

목차

환영합니다 3
사용 목적 4
중요 사용자 정보 4
금기 5
경고 5
사용 전 주의사항 8
치료 결정에 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 사용하기 12
치료 결정 내리기 13
CGM 치료 결정 시 해야 할 것 14
CGM 치료 결정 시 하지 말아야 할 것 14
시스템 개요 16
앱 설정하기 17
스마트 장치 설정 21
센서 삽입하기 22
트랜스미터 부착하기 24
캘리브레이션 일정 25
최초 혈중 글루코즈(BG) 측정값 입력하기 26
혈중 글루코즈(BG) 측정값 입력을 위한 팁 27
12시간 간격으로 혈중 글루코즈(BG) 측정값 입력 27
홈 화면 보기 28
현재 상태 28
진행 상황 29
이전 상태 30

이벤트 31
스마트 워치 32
긴급 저혈당 알람 37
고급 경고 37
트랜스미터 보증 40
장치 성능 특징 42
제품 사양 42
문제 해결 47
패키지 라벨의 기호 54
용어 해설 56

주요 연락처 및 전화번호

Dexcom 웹사이트: dexcom.com

트랜스미터 일련번호(SN): _____

귀하의 의료전문가: _____

가장 가까운 병원: _____

지역 Dexcom 대리점: _____

기타 참고 사항: _____

_____

_____

Dexcom | G5 mobile

시작하기 가이드

환영합니다

Dexcom G5 Mobile CGM(Continuous Glucose Monitoring) 시스템을 시작하게 되신 것을 축하드립니다!

Dexcom G5 Mobile Continuous Glucose Monitoring System(Dexcom G5 Mobile CGM 시스템)을 사용하면 최대 7일 동안 5분마다 실시간으로 연속적인 센서 포도당 수치를 확인할 수 있습니다. 이 수치는 포도당 레벨의 트렌드와 패턴을 발견하는 데 도움이 되므로, 포도당 레벨의 이전 상태는 어떠했는지, 현재 어떤 방향으로 전개되고 있는지, 그리고 얼마나 빨리 증가하거나 감소하고 있는지 알 수 있습니다.

이 가이드를 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 설정하고 사용하는 데 도움이 되는 자료로 활용하십시오. 시스템에 대한 지원이 필요한 경우 지역 Dexcom 대리점에 문의하시기 바랍니다. 일부 사용자는 보호자가 관리에 참여할 필요가 있을 수도 있습니다. 이에 대해 의사와 상담하십시오.

시작하기 전에 궁금한 사항이 있을 경우 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 사용자 가이드를 살펴보십시오. dexcom.com/guides 또는 Dexcom G5 Mobile 앱에서 사용자 가이드를 받으십시오(메뉴 > 도움말 > 사용자 가이드).

경고: Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 사용하기 전에 사용자 가이드의 모든 금기, 경고, 사용 전 주의사항, 세부 절차를 읽어보십시오.

사용 목적

Dexcom G5 Mobile 연속적인 포도당 모니터링 시스템은 2세 이상 당뇨병 환자의 관리를 위한 포도당 모니터링 시스템입니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 당뇨병 치료 결정을 위한 손가락 채혈 혈당 검사를 대체하기 위해 설계되었습니다.

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 결과의 해석은 포도당 트렌드와 시간 경과에 따른 몇 가지 순차적 수치를 기반으로 해야 합니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 급성 및 장기 치료 조정을 용이하게 해 주는, 고혈당과 저혈당 상황의 감지에 도움을 줍니다.

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 가정에서 환자가 사용하도록 고안되었습니다.

중요 사용자 정보

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템과 구성품을 사용 지침 및 모든 적응증, 금기, 경고, 사용 전 주의사항 및 주의에 따라 사용하지 않는 경우 중증 저혈당증(저혈당)이나 중증 고혈당증(고혈당)의 발견을 누락하거나 또는 피해를 발생시키는 치료 결정을 하게 되는 결과를 초래할 수 있습니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 포도당 경고와 수치가 귀하의 증상이나 예상과 맞지 않을 경우, 혈당계의 손가락 채혈 혈당값을 사용하여 당뇨병 치료 결정을 하십시오. 필요한 경우 의사의 진료를 받으십시오.

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 사용하기 전에 제품 설명서를 검토하십시오. 적응증, 금기, 경고, 사용 전 주의사항, 주의 및 기타 중요한 사용자 정보는 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템에 포함되었거나 함께 제공되는 제품 설명서에서 찾을 수 있습니다. 당뇨병 관리에 도움을 주는 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 표시 정보를 활용하는 방법에 대해 귀하의 의료전문가와 상의하십시오. 제품 설명서에는 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 문제 해결 및 시스템의 성능 특성에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.

금기

MRI/CT/투열 요법

MRI(Magnetic Resonance Imaging), CT(Computed Tomography) 또는 투열 요법(high-frequency electrical heat) 치료 전에는 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 센서와 트랜스미터를 제거하십시오.

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 MRI, CT 스캔 또는 투열 요법 치료 중에 테스트된 적이 없습니다. 자기장이나 열은 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 구성품을 손상시킬 수 있으며, 이는 혈당 수치를 부정확하게 표시하거나 경고를 막을 수 있습니다.

약물 복용

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 사용 중 파라세타몰/아세트아미노펜의 복용은 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템이 생성하는 포도당 수치를 부정확하게 높일 수 있습니다. 부정확함의 정도는 신체에서 작용 중인 파라세타몰/아세트아미노펜 양에 따라 달라지며, 사람마다 다릅니다. 파라세타몰/아세트아미노펜을 최근에 복용한 경우, Dexcom G5 Mobile CGM 시스템이 생성한 연속적인 포도당 모니터링(CGM) 데이터에 의지하면 안 됩니다.

경고

다음의 경고는 중증 저혈당증(저혈당) 또는 중증 고혈당증(고혈당)의 발견을 누락하거나 또는 피해를 발생시키는 치료 결정을 하게 되는 결과를 초래할 수 있습니다.

센서 파손

파손된 센서를 무시하지 마십시오. 드물지만 센서는 파손되거나 팟(pod)에서 분리될 수 있습니다. 센서가 파손되어 피부 위에 센서의 일부가 보이지 않는 경우, 센서를 제거하려고 하지 마십시오. 삽입 부위에 감염이나 염증 - 발적, 붓기, 통증 - 증상이 있다면 전문적인 의료적 도움을 받으십시오. 센서가 손상된 경우 지역 Dexcom 대리점에 이를 알리십시오.

손상된 제품을 사용하지 마십시오

Dexcom G5 Mobile 트랜스미터가 손상되었거나 균열이 있다면 사용하지 마십시오. 이는 전기 안전 위험을 발생시켜 감전의 원인이 될 수 있으며 부상을 입을 수 있습니다. 또한, 손상되었거나 균열이 있는 G5 Mobile 트랜스미터는 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 정상적으로 작동하지 않게 할 수 있습니다.

질식

어린 아이들이 어른의 감독 없이 센서나 트랜스미터를 만지지 못하게 하십시오. 센서 및 트랜스미터에는 질식 위험이 있는 작은 부분품이 포함되어 있습니다.

훈련 자료 검토

사용하기 전에 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템과 함께 제공되는 훈련 자료를 검토하십시오. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 잘못 사용하면 시스템에서 생성된 정보를 오해하거나 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

당뇨병 치료 결정

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템이 센서 포도당 수치를 표시하지 않거나 일관성 없는 수치가 나올 경우, 혈당계의 손가락 채혈 혈당값을 사용하여 당뇨병 치료 결정을 하십시오.

낮음/높음 증상을 무시하지 마십시오

저혈당 또는 고혈당 증상을 무시하지 마십시오. 포도당 경고와 수치가 귀하의 증상이나 예상과 맞지 않을 경우, 당뇨병 치료 결정을 내리거나 즉각적인 진찰을 받기 위해서는 혈당계의 손가락 채혈 혈당값을 구해야 합니다.

사용해서는 안 되는 사용자

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 다음과 같은 사람의 사용에 대해 평가되거나 승인되지 않았습니다.

- 임신한 여성
- 투석 환자

이 그룹에 속한 사람들에게는 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 정확도가 테스트되지 않았으며, 시스템의 포도당 수치가 부정확할 수 있습니다.

일정에 따른 캘리브레이션

최소 12시간마다 한 번씩 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 캘리브레이션 해야 합니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 정확한 수치를 제공하기 위해 캘리브레이션이 필요합니다. 초기 캘리브레이션 후 장치의 프롬프트에 따라 12시간마다 캘리브레이션을 한 경우가 아니면 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 당뇨병 치료 결정에 활용하지 마십시오.

배치

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 센서 구성품을 배/복부(2세 이상) 또는 위쪽 엉덩이(2세에서 17세) 이외의 부위에 삽입하지 마십시오. 다른 부위에 대한 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 센서 구성품 배치와 삽입은 승인되지 않았습니다. 다른 부위에 배치하면 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

초기 캘리브레이션: 날짜/알람/경고

2시간 동안의 시동 전까지는 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 센서 포도당 수치 또는 알람/경고를 기대하지 마십시오. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 센서 포도당 수치 또는 알람/경고는 2시간 동안의 시동이 종료되고 사용자가 시작 캘리브레이션을 완료할 때까지 제공되지 않습니다. 2시간 동안의 시동 중에는 혈당계의 손가락 채혈 혈당값을 사용하십시오.

센서 보관

센서 수명의 보존 기간을 위해 센서를 2°C-25°C 사이의 온도에 보관하십시오. 이 온도 범위 내에 속하면 센서를 냉장고에 보관할 수 있습니다. 센서를 냉동고에 보관하면 안 됩니다.

센서를 잘못 보관하면 센서 포도당 수치가 부정확해질 수 있습니다.

스마트 장치 설정

귀하의 스마트 장치 내부 설정은 모든 Dexcom G5 Mobile 앱 설정을 무효로 합니다.

알람 또는 경고를 받으려면 다음을 반드시 수행해야 합니다.

- 스마트 장치의 설정 메뉴에서 G5 Mobile App 알림이 켜져 있는지 확인합니다.

- 스마트 장치에서 G5 Mobile 앱이 종료되지 않았는지 확인합니다.
- G5 Mobile 앱을 제대로 작동하게 하려면 스마트 장치에서 *Bluetooth*®를 켜야 합니다.
- 스마트 장치의 방해 금지 모드 기능은 (가능한 경우) 끈 상태여야 합니다.
- 스마트 장치를 재시작한 후 G5 Mobile 앱을 재시작합니다.
- 스마트 장치의 볼륨을 들을 수 있는 정도로 설정합니다.
- G5 Mobile 앱을 닫지 마시고 항상 배경에서 작동되게 합니다.

스마트 장치의 설정이 잘못된 경우 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 알람/경고 진동은 스마트 장치의 다른 진동 앱과 다르지 않습니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 앱과 같은 의료 기기 앱은 귀하의 스마트 장치 기능보다 특별한 우선 사항이 없습니다. 진동이 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 앱의 알림인지 아니면 다른 앱인지 단정할 수 없습니다. 알 수 있는 유일한 방법은 화면을 보는 것입니다.

알람 또는 경고를 놓치셨습니까?

헤드폰이 연결되어 있으면, Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 앱의 알람 또는 경고를 스마트 장치의 스피커를 통해 들을 수 없습니다.

사용을 마치면 헤드폰을 분리하십시오. 그렇지 않으면 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 알람 또는 경고를 듣지 못할 수 있습니다.

사용 전 주의사항

다음의 사용 전 주의사항은 중증 저혈당증(저혈당) 또는 중증 고혈당증(고혈당)의 발견을 누락하거나 또는 피해를 발생시키는 치료 결정을 하게 되는 결과를 초래할 수 있습니다.

당뇨병 환자는 혈당 관리를 위해 받는 모든 치료 또는 당뇨병 치료 조정에 대해 의사로부터 진단을 받거나 치료를 받아야 합니다. 이런 결정은 승인된 혈당 모니터링 장치(혈중 글루코즈(BG) 미터)를 통해 12시간마다 캘리브레이션된 포도당(포도당) 센서를 사용하여 측정된 데이터를 통해 이루어져야 합니다.

히드록시우레아 관련 주의사항

히드록시우레아를 복용하시는 경우, G5 수치가 잘못하여 높게 나올 수 있어 저혈당 경고가 표시되지 않거나 당뇨병 관리 결정에 오류가 발생할 수 있습니다. 부정확함의 정도는 체내 히드록시우레아의 양에 따라 다릅니다. 혈당계를 사용하십시오.

센서 패키지

멸균된 패키지가 손상되었거나 개봉된 경우 G5 Mobile 센서를 사용하지 마십시오. 멸균 상태가 아닌 센서의 사용은 감염을 유발할 수 있습니다.

사용 전 세정 및 건조

비누와 물로 손을 씻고 건조될 때까지 센서 패키지를 열지 마십시오. 센서를 삽입하는 과정에서 손이 오염되었을 경우 삽입 부위를 오염시킬 수 있으며 감염될 수 있습니다.

삽입 부위 근처의 피부를 이소프로필알코올과 같은 국소 향균 용액으로 청결하게 한 후 건조될 때까지 센서를 삽입하지 마십시오. 청결하지 않은 피부에 삽입하면 감염으로 이어질 수 있습니다. 세정한 부위가 건조될 때까지 센서를 삽입하지 마십시오. 그래야 센서 접착제가 더 잘 달라붙습니다.

재사용 가능: 버리지 마십시오

트랜스미터를 폐기하지 마십시오. 재사용이 가능한 제품입니다. 트랜스미터의 배터리 수명이 끝날 때까지 동일한 트랜스미터가 각 세션에 사용됩니다.

정확하고 신속하게

시스템을 캘리브레이션하려면, 신중하게 측정한 손가락 채혈 혈당 측정으로 혈당계에 표시된 정확한 혈당값을 5분 안에 입력하십시오.

캘리브레이션에 대해 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 센서 포도당 수치를 기입하지 마십시오. 정확하지 않은 혈당값 또는 입력 시점에서 5분 이전에 획득한 혈당값이나 센서 포도당 수치를 입력할 경우, 센서 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

치료 결정

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템에서 생성한 센서 포도당 수치, 트렌드 화살표, 트렌드 그래프 및/또는 조치가 가능한 경고를 복합적으로 고려하여 당뇨병 치료 결정을 내립니다.

유효기간

유효기간이 지난 Dexcom G5 Mobile CGM 센서를 사용하지 마십시오. 센서를 삽입하기 전, 패키지 라벨에 다음의 형식으로 기재된 유효기간을 확인하십시오: 년-월-일

센서 포도당 수치가 정확하지 않을 수 있으므로 유효기간이 지난 센서를 사용하지 마십시오.

센서 배치

센서 삽입 시 동일한 부위에 반복적인 사용을 피하십시오. 센서 배치 부위를 바꿔가며 사용하고, 연속해서 두 번의 센서 세션에 같은 부위를 사용하지 마십시오. 동일한 부위를 사용할 경우 흉터 또는 피부 자극을 유발할 수 있습니다.

부딪히거나 눌리거나 압박이 가해질 가능성이 있는 부위 또는 흉터, 문신 또는 자극이 있는 부위는 포도당 측정에 이상적인 부위가 아니므로 센서를 삽입하지 마십시오. 이러한 부위에 삽입하면 센서 정확도에 영향을 줄 수 있습니다.

센서에서 7.5cm 이내에 인슐린을 주입하거나 인슐린 펌프 주입 세트를 배치하지 마십시오. 인슐린이 센서 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

맞는 트랜스미터와 센서 사용하기

Dexcom의 연속적인 포도당 모니터링 시스템 트랜스미터는 다른 세대 간에 서로 호환이 되지 않습니다.

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 트랜스미터는 Dexcom G4 PLATINUM CGM 시스템과 호환되지 않습니다. 다른 세대의 트랜스미터와 혼용할 경우 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 작동하지 않습니다.

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템과 함께 Dexcom G4 PLATINUM 센서 또는 Dexcom G5 Mobile/G4 PLATINUM 센서를 사용할 수 있습니다. 센서를 사용하기 전, 센서 라벨에 "Dexcom G5 Mobile/G4 PLATINUM 센서"라고 표시되었는지 확인합니다.

통신 범위

트랜스미터와 디스플레이 장치를 6미터 이상 떨어뜨려 놓지 않도록 합니다. 트랜스미터에서 디스플레이 장치까지의 전송 범위는 방해물이 없을 경우 최대 6미터입니다. 무선 통신은 물을 통과할 경우 잘 작동하지 않으므로 사용자가 수영장, 욕조 또는 물침대 등에 있다면 전송 범위는 훨씬 더 작습니다.

방해물의 유형은 다양하며, 테스트되지 않았습니다. 트랜스미터와 디스플레이 장치가 6미터 이상 떨어져 있거나 방해물로 분리되어 있는 경우 통신하지 못하거나 통신 거리가 짧을 수 있습니다.

켜짐 상태 확인

디스플레이 장치가 꺼진 경우, Dexcom G5 Mobile CGM 시스템이 생성한 센서 포도당 수치, 알람 또는 경고가 표시되지 않습니다. 디스플레이 장치가 켜졌는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 센서 포도당 수치, 알람 또는 경고를 받을 수 없습니다.

대체 부위 검사 금지

캘리브레이션을 위해 대체 부위 혈당 검사(손바닥이나 팔뚝, 기타 등등의 혈액)를 사용하지 마십시오. 대체 부위 혈당값은 손가락 채혈 혈당값과 다를 수 있으며 적절한 시간의 혈당값을 나타내는 것이 아닐 수 도 있습니다. 캘리브레이션을 위해서는 손가락 채혈로 측정한 혈당값만 사용하십시오. 대체 부위 혈당값은 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.

캘리브레이션을 하지 않아야 하는 경우

혈당이 상당한 속도로, 즉 일반적으로 분당 2mg/dL 이상 변하는 경우에는 캘리브레이션을 하지 마십시오. 디스플레이 장치에서 귀하의 혈당이 빠르게 상승 또는 감소하는 것을 가리키는 상승 또는 감소 싱글 화살표 또는 이중 화살표를 표시하는 경우, 캘리브레이션을 하지 마십시오. 혈당이 빠르게 상승 또는 감소하는 동안의 캘리브레이션은 센서 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.

치료 결정에 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 사용하기

혈중 글루코즈(BG) 측정값은 수치일 뿐입니다.

수치만으로는 부족합니다.

트렌드 그래프는 포도당의 속도와 방향에 대한 정보를 제공하며, 단순한 수치만 나열하지 않습니다.

혈당계 수치가 다음과 같다면 어떻게 해야 할까요?

위와 달리 이렇게 표시된다면 어떤 다른 대응을 하시겠습니까?

95mg/dL 값이 급격히 감소하는 것과 95mg/dL 값이 급격히 증가하는 것은 다른 문제입니다.

치료 결정 내리기

치료 결정을 하기 전에 다음 네 가지 항목을 확인하십시오.

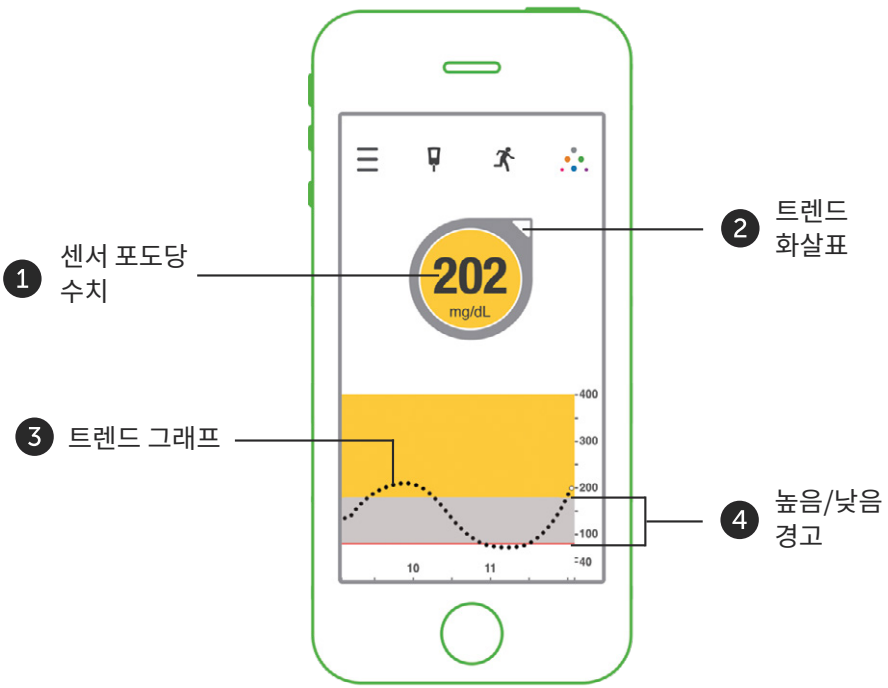

Dexcom CGM을 기준으로 치료 결정을 하기 전에 네 가지 항목을 모두 살펴보아야 합니다. 네 가지 항목을 모두 사용하지 않을 경우, 잘못된 치료 결정을 내릴 수 있습니다.

CGM 치료 결정 시 해야 할 것

- 치료 결정은 4가지 핵심 요소인 센서 포도당 수치, 트렌드 화살표, 트렌드 그래프, 알람/경고를 기준으로 하십시오.
- 사전 예방적인 태도를 취하십시오 - CGM을 자주 확인합니다.
- 의료전문가와 상의하여 관리 계획을 세우십시오.
- 이전의 치료 결정 중 어떤 것이 가장 효과가 있었는지 알아보십시오.
- **트렌드를 기준으로 치료 결정을 내리십시오. 트렌드는 최근 15분 이내의 센서 포도당 수치가 3개 이상으로 이루어진 것입니다(각 점은 5분간의 센서 포도당 수치를 의미함).**

정상 - 최근 15분 이내의 수치 3개

비정상 - 최근 15분 이내의 수치가 1개 밖에 없음

수치가 1개 밖에 없을 경우 트렌드 화살표가 표시되지 않음

CGM 치료 결정 시 하지 말아야 할 것

고탄수화물 + 식사로 인한 급상승 = 정상

- 너무 짧은 시간 내에 인슐린을 여러 번 투여하지 마십시오.
- 센서 정보에 과잉 반응하지 마십시오.

지켜보며 기다리십시오. 과잉 반응을 하지 마십시오.

CGM 치료 결정 시 하지 말아야 할 것(계속)

- 센서 포도당 수치가 이전의 경험과 일치하지 않을 경우 CGM을 사용하여 치료 결정을 내리지 마시고, 혈중 글루코즈(BG) 미터를 사용하십시오.

- 증상이 센서 포도당 수치와 일치하지 않을 경우 CGM을 사용하여 치료 결정을 내리지 마시고, 혈중 글루코즈(BG) 미터를 사용하십시오.

- 트렌드 화살표가 없는 경우 치료 결정을 하지 마십시오.

- 파라세타몰/아세트아미노펜을 복용한 경우 CGM을 사용하여 치료 결정을 내리지 마시고, 혈중 글루코즈(BG) 미터를 사용하십시오.

치료 결정에 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 가이드를 참조하십시오. dexcom.com/guides 또는 앱에서 사용자 가이드를 받으십시오(메뉴 > 도움말 > 사용자 가이드).

시스템 개요

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 다음과 같이 구성됩니다.

1. 센서와 어플리케이터

- 어플리케이터를 사용하여 센서를 삽입함
- 소형 센서가 피부 바로 아래에서 센서 포도당 레벨을 측정함
- 최대 7일간 착용 가능
- 사용 후 센서와 어플리케이터는 폐기함

2. 트랜스미터

- 팟(pod)에 넣음
- 센서 포도당 정보를 Dexcom G5 Mobile 앱에 무선으로 전송함
- 3개월의 배터리 수명 기간 동안 재사용 가능

3. Dexcom G5 Mobile 앱

스마트 장치의 Dexcom G5 Mobile 앱(앱)*

- 센서 포도당 수치가 표시됨

  알람/경고를 설정하고 받아 볼 수 있음
- 디스플레이 장치와 트랜스미터는 서로 6미터 거리 이내를 유지해야 함

*이 앱은 모든 스마트 장치와 국가에서 사용 가능한 것은 아닙니다. dexcom.com/compatibility에서 자세한 내용을 확인하십시오. 스마트 장치 화면은 그림과 약간 다르게 표시될 수 있습니다.

앱 설정하기

1

앱 스토어에서 Dexcom G5 Mobile 앱을 설치합니다.

2

로그인

등록

기존 Dexcom 계정으로 앱에 로그인하거나 새 계정을 등록합니다.

3

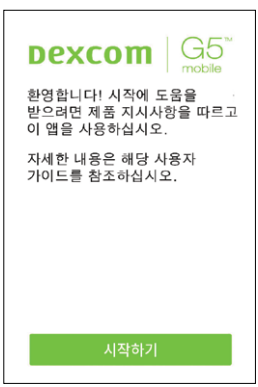

로그인하면 이 화면이 표시되고 설정 프로세스를 안내하는 내용이 표시됩니다.

이 과정은 약 20분 정도 소요되며 다음과 같은 작업이 포함됩니다.

- 높음 경고와 낮음 경고 설정하기
- 장치 설정 조정하기
- 트랜스미터 일련번호 입력하기
- 센서 삽입과 트랜스미터 부착하기
- 트랜스미터를 앱과 페어링하기
- 2시간의 센서 가동 준비 시작하기

낮음 또는 높음 경고 레벨 설정하기

4

귀하의 저혈당 경고를 설정합니다.

기본 설정값은 80mg/dL입니다.

다른 양을 선택하려면 스크롤합니다.

저장을 누르고 진행합니다.

설정이 되면, 포도당이 설정된 양 이하로 떨어진 경우 경고 알림을 받게 됩니다.

5

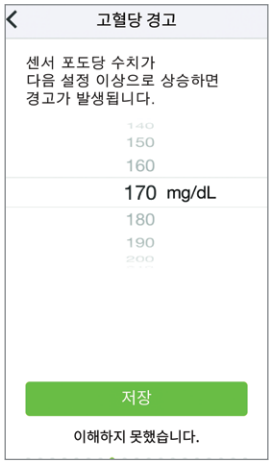

귀하의 고혈당 경고를 설정합니다.

기본 설정값은 200mg/dL입니다.

다른 양을 선택하려면 스크롤합니다.

저장을 누르고 진행합니다.

설정이 되면, 포도당이 설정된 양 이상으로 올라간 경우 경고 알림을 받게 됩니다.

앱과 트랜스미터 페어링하기

6

Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다.

앱은 Bluetooth가 "켜짐" 상태인지 확인합니다.

Bluetooth는 Wi-Fi 또는 셀룰러 데이터보다 에너지 소비량이 적으며 범위가 짧습니다.

7

트랜스미터 박스를 준비합니다.

사진 촬영을 누릅니다.

앱이 카메라를 사용할 수 있도록 허용하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 허용을 누릅니다.

또는 일련 번호(SN)를 직접 입력합니다.

앱과 트랜스미터 페어링하기

8		스마트 장치와 트랜스미터가 연결될 때까지 최대 30분 동안 기다립니다.

센서 세션 시작하기

9		2시간의 센서 가동 준비를 시작하기 위해 센서 가동 준비 원을 누릅니다. 참고: 2시간의 센서 가동 준비 기간 동안은 센서 포도당 수치, 알람/경고를 받을 수 없습니다.

스마트 장치 설정

이 앱은 의료 앱이긴 하지만, 기능하는 방식은 여타 앱과 같습니다. 사용자의 설정은 경고에 영향을 미칩니다.

CGM 경고를 받으려면 Dexcom이 알림을 보낼 수 있도록 허용해야 합니다. 이러한 알림에는 CGM 정보만 포함됩니다. 홍보성 알림은 앱으로 전송되지 않습니다.

잠김 화면에서 볼 수 있도록 스마트 장치 설정에서 알림을 허용했는지 확인합니다. 장치의 소리와 진동을 자주 확인합니다.

다음은 CGM 알림과 앱 내 경고의 예시입니다.

알림이 사용자에게 전송됩니다. 설정에 따라 스마트 장치의 진동 및/또는 소리로 경고를 알립니다.

앱에 경고가 표시되면 **확인**을 눌러 경고를 확인합니다.

소리 경고를 받으려면 다음과 같이 설정해야 합니다.

- 소리가 충분히 들리도록 볼륨을 크게 설정합니다.
- *Bluetooth*: **켜짐**
- **방해 금지 모드: 꺼짐**(방해 금지 모드를 사용할 경우, 소리 또는 진동 경고를 받지 못할 수 있음)

전체 권장 설정 목록은 dexcom.com/guides 또는 앱에서 사용자 가이드를 참조하십시오(메뉴 > 도움말 > 사용자 가이드). 위의 설정을 설정하는 방법에 대한 내용은 스마트 장치의 사용자 가이드를 참조하십시오.

헤드폰을 꽂으면 스피커에서 소리가 나오지 않으므로, 높음 또는 낮음 경고를 놓칠 수 있습니다.

경고를 받으려면 앱이 배경에서 항상 실행되고 있어야 합니다. 이것은 배터리 사용량을 증가시킵니다. 장치를 계속 충전하도록 하십시오.

스마트 장치에서 수동으로 시간을 변경하면 앱이 작동을 멈출 수 있습니다.

센서 삽입하기

시작하기 전에 알코올 천, 센서 및 트랜스미터를 준비하십시오. 피부 준비나 접착 제품(Mastisol®, Skin Tac™)은 선택사항입니다. 손을 씻고 건조시킵니다.

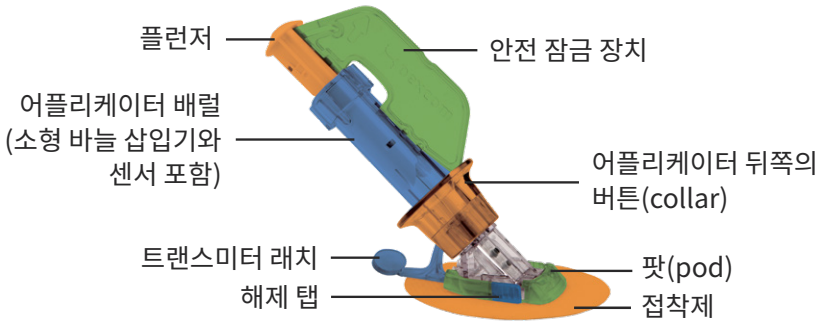

인슐린 펌프 주입 세트 또는 주입 부위에서 최소 8cm 떨어지고 손목 밴드 경로가 아닌 부위를 선택하십시오. 부딪히거나 눌릴 가능성이 높거나 흉터, 문신 또는 자극이 있는 부위는 피하십시오.

18세 이상:
배에 삽입합니다.

2-17세:
배 또는 위쪽 엉덩이에 삽입합니다.

1



알코올 천으로 센서 배치 부위의 피부를 깨끗이 합니다.

건조시킵니다.

2



선택적 피부 접착제를 사용하는 경우 접착 패치를 부착할 원형 모양에 부착합니다. 깨끗한 피부의 중심으로 센서를 삽입합니다.

3



팟(pod)에서 접착제 보호 필름을 한 번에 절반을 떼어냅니다.

4



피부에 수평으로 팟(pod)을 부착합니다.

접착 패치 둘레를 손가락으로 눌러 테이프를 피부에 고정시킵니다.

5



어플리케이터를 잡고 안전 잠금 장치를 똑바로 당깁니다.

6



흰색 접착제 가장자리에 한 손의 손가락을 놓습니다.

이 손으로 피부를 집을 수 있습니다.

7



어플리케이터 뒤쪽의 버튼(collar) 위에 손가락 두 개를 놓고 엄지 손가락은 흰색 플런저 위에 놓습니다. 플런저를 누릅니다. 딸깍 소리가 두 번 들려야 합니다.

8

어플리케이터 뒤쪽의 버튼(collar) 위에서 아래쪽으로 손가락을 이동시킵니다. 딸깍 소리가 두 번 들리거나 더 이상 뒤로 당길 수 없을 때까지 엄지 손가락 쪽으로 어플리케이터 뒤쪽(collar)의 버튼을 당깁니다.

9



팟(pod)의 측면에 있는 **골이진 탭을 압착합니다.**

10



탭을 압착하면서, 어플리케이터 배럴을 앞쪽으로 빼서 몸에서 떨어지게 합니다. 어플리케이터를 적법한 절차에 따라 폐기하십시오.

트랜스미터 부착하기

센서를 삽입했으면 트랜스미터를 팟(pod)에 연결해야 합니다.

사용할 준비가 되기 전까지는 트랜스미터를 해당 상자에 보관합니다.

1		알코올 천으로 트랜스미터의 뒷면을 깨끗이 합니다. 건조시킵니다.
2		트랜스미터를 팟(pod)에 놓습니다(평평한 면이 아래, 얇은쪽이 트랜스미터 래치에서 멀게).
3		트랜스미터에 손가락 하나를 놓고 제위치에 유지시킵니다. 다른 손으로 "딸깍 소리"가 두 번 들릴 때까지 위쪽과 앞쪽으로 트랜스미터 래치를 밀어올립니다.
4		한 손으로 팟(pod)의 측면을 잡습니다. 다른 한 손으로 트랜스미터 래치를 빨리 비틀면서 몸 밖으로 떼어내 제거합니다.

캘리브레이션 일정

정확성을 보장하기 위해 Dexcom G5 Mobile CGM을 주기적으로 캘리브레이션해야 합니다. Dexcom G5 Mobile CGM을 캘리브레이션할 경우에는 BG 미터의 값만 사용하십시오.

월요일(센서 세션 1일차)

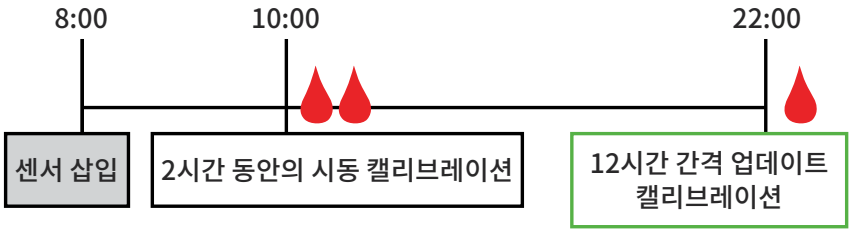

화요일 - 일요일(센서 세션 2-7일차)

7일간의 센서 세션 중의 최소 캘리브레이션 일정 예시

최초 혈중 글루코즈(BG) 측정값 입력하기

2시간의 가동 준비가 끝나면, 센서 포도당 수치가 시작되기 전에 서로 다른 2개의 BG 측정값을 입력해야 합니다.

1		혈중 글루코즈(BG) 측정값 2개를 입력해야 할 때가 되면 앱에서 경고가 표시됩니다. 앱으로 이동하여 값을 입력합니다.
2		손을 씻고 건조시킵니다.
3		혈중 글루코즈(BG) 미터를 사용하여 손가락 채혈 혈당을 측정합니다.
4		원을 누르고, 값이 나오는 5분 이내에 혈중 글루코즈(BG) 측정값을 입력합니다.
5		혈중 글루코즈(BG) 미터의 정확한 값을 입력합니다. **저장**을 누릅니다.
6		위 단계를 반복하여 두 번째 손가락 채혈에서 얻은 두 번째 혈중 글루코즈(BG) 측정값을 입력합니다. 서로 다른 2개의 혈중 글루코즈(BG) 측정값을 입력해야 정확한 수치를 보장할 수 있습니다.

혈중 글루코즈(BG) 측정값 입력을 위한 팁

혈중 글루코즈(BG) 측정값 입력 시 해야 할 것:

- 손을 씻고 건조시킨 후에 입력합니다.
- 혈중 글루코즈(BG) 미터에서 값이 나오는 5분 이내에 입력합니다.
- 혈중 글루코즈(BG) 미터의 정확한 수치를 사용하여 입력합니다.
- 손가락 채혈 혈당값만 사용하여 입력합니다.
- 최소 12시간 간격으로 입력합니다.

혈중 글루코즈(BG) 측정값 입력 시 하지 말아야 할 것:

- 값이 400mg/dL 이상이거나 40mg/dL 이하일 경우 입력하지 마십시오.
- 화면에 ???(물음표) 또는 신호 없어짐 오류가 표시되면 입력하지 마십시오.
- 파라세타몰/아세트아미노펜을 복용한 후에는 입력하지 마십시오.

12시간 간격으로 혈중 글루코즈(BG) 측정값 입력

최초 혈중 글루코즈(BG) 측정값을 입력한 후에는 최소 12시간마다 한 번씩 혈중 글루코즈(BG) 측정값을 입력해야 합니다.

혈중 글루코즈(BG) 측정값이 필요해지면 미터 아이콘에 빨간색 배지가 표시됩니다.

경고: 최소 12시간마다 한 번씩 G5 Mobile CGM 시스템을 캘리브레이션해야 합니다. G5 Mobile 시스템은 정확한 수치를 제공하기 위해 캘리브레이션이 필요합니다.

자세한 내용은 dexcom.com/guides 또는 앱에서 (메뉴 > 도움말 > 사용자 가이드) 사용자 가이드를 참조하십시오.

오류 메시지가 표시될 경우, 파란색 물음표를 클릭하고 지침을 따르십시오.

홈 화면 보기

현재 상태

현재 상태를 확인하려면 색상과 수치를 살펴보십시오.

빨간색 = 낮음

노란색 = 높음

회색 = 목표 범위 내

시스템에 문제가 있거나 오류가 발생할 수 있습니다. 이 경우 홈 화면에 해당 문제 또는 오류와 관련된 정보가 포함된 검은색 원이 표시됩니다. **검은색 원이 표시되면 센서 포도당 수치 또는 경고를 받을 수 없습니다.** 자세한 내용을 확인하려면 파란색 물음표를 누릅니다.

진행 상황

진행 상황을 확인하려면 트렌드 화살표를 살펴보십시오. 여기에서 수치만 확인해서는 안 됩니다. 포도당 변화의 방향과 속도를 주의 깊게 살펴보십시오.

앱	한눈에 보고 관찰하기	포도당 변화 상태
		안정적: 분당 1mg/dL 이상 증가/감소하지 않습니다.
		서서히 감소 중: 포도당이 15분 후 최대 30mg/dL까지 감소할 수 있습니다.
		감소 중: 포도당이 15분 후 최대 45mg/dL까지 감소할 수 있습니다.
		급격히 감소 중: 포도당이 15분 후 최대 45mg/dL 이상 감소할 수 있습니다.
		서서히 증가 중: 포도당이 15분 후 최대 30mg/dL까지 증가할 수 있습니다.
		증가 중: 포도당이 15분 후 최대 45mg/dL까지 증가할 수 있습니다.
		급격히 증가 중: 포도당이 15분 후 최대 45mg/dL 이상 증가할 수 있습니다.
	화살표 없음	시스템이 포도당 변화의 속도와 방향을 계산할 수 없습니다.

CGM은 분당 mg/dL을 측정하며, 이 차트에서는 15분당 수치를 계산합니다.

이전 상태

이전 상태를 확인하려면 트렌드 그래프를 살펴보십시오. 스마트 장치를 가로 방향으로 돌려 그래프를 크게 표시합니다.

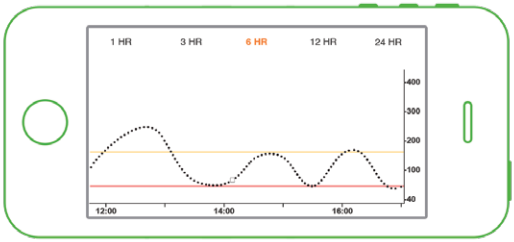

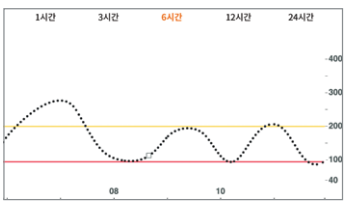

그래프 색상

- 노란색: 목표 지점 또는 그 이상
- 회색: 목표 범위 이내
- 빨간색: 목표 지점 또는 그 이하

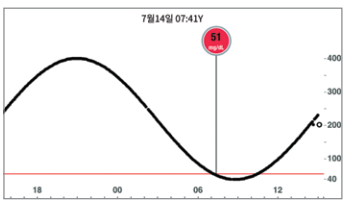

히스토리 보기

시간 프레임의 센서 포도당 수치를 보여주는 시간을 누릅니다.

하루 동안의 나머지 센서 포도당 수치를 보려면 손가락으로 화면 전체를 밉니다.

각 점은 5분마다 측정한 센서 수치를 나타냅니다.

데시리터당 밀리그램으로 표시(mg/dL).

신호 없어짐 기간 후 그래프에 과거 수치가 나타날 수 있습니다.

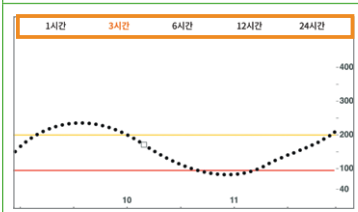

그래프 시간 프레임

기본 설정값은 가장 최근 3시간입니다.

가장 최근의 1, 3, 6, 12, 24시간 수치에 대한 시간 라벨을 누릅니다.

이벤트

앱에서 이벤트를 기록할 수 있습니다. 이벤트 기록은 포도당 패턴을 검토할 때 유용한 도구일 수 있습니다. 기록할 수 있는 이벤트는 다음과 같습니다.

- 탄수화물
- 인슐린
- 운동
- 건강
  - 질병
  - 스트레스
  - 고혈당 증상
  - 저혈당 증상
  - 월경 주기
  - 알코올

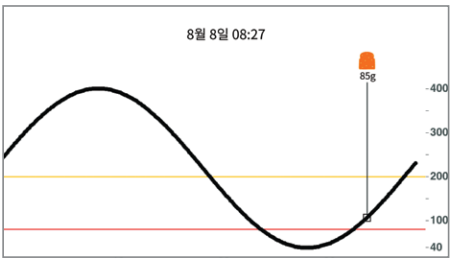

화면 전체를 손가락으로 밀거나 네모 칸을 터치하면 이벤트 정보를 볼 수 있습니다 (수평 보기에만 해당).

한눈에 보기

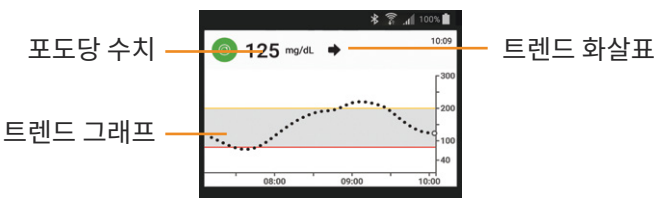

한눈에 보기는 알림 영역에서 CGM을 보여줍니다. 화면 상단 끝에서 아래로 살짝 밉니다.

한눈에 보기를 눌러 앱을 엽니다. 먼저 사용자의 장치를 잠금 해제해야 합니다.

한눈에 보기는 켜짐이 기본 설정값입니다. 끄려면 메뉴>경고>한눈에 보기로 이동하십시오.

오류 기호와 메시지는 한눈에 보기에 나타나지 않습니다. 시스템 상태를 확인하려면 앱을 여십시오.

스마트 워치

호환 가능한 스마트 워치에서 포도당 정보를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 dexcom.com/compatibility를 방문하십시오.

시스템과 스마트 워치를 함께 사용하면 알람 및 경고의 수신 방법이 변경될 수 있습니다.

- 귀하의 트랜스미터는 스마트 워치가 아닌, 오직 스마트 장치로만 통신할 수 있습니다. 스마트 장치와 연결되지 않은 경우 스마트 워치로 센서 수치, 알람 또는 경고를 받을 수 없습니다.
- 스마트 장치와 스마트 워치 모두에 알림을 보내도록 장치 설정을 하십시오.
- 앱의 알림을 사용하지 않도록 설정하거나 알림을 차단하지 마십시오.
- 스마트 워치를 페어링한 후에는 알림 수신 방식을 이해했는지 확인하십시오.
- 알람 또는 경고를 놓치지 않으려면 항상 스마트 워치를 착용하시기 바랍니다. 페어링이 유지된 상태로 스마트 워치를 풀어두면 알람이나 경고를 놓칠 수 있습니다.

그림 8.Dexcom 워치 페이스

센서 세션 종료

센서는 7일 후 자동으로 종료됩니다.

세션 종료

센서 세션이 종료되기 전 6시간, 2시간, 30분 간격으로 앱에서 경고를 보냅니다.

센서 포도당 수치를 계속 받게 됩니다.

이 화면이 표시되어 남은 시간을 알려줍니다.

세션 종료됨

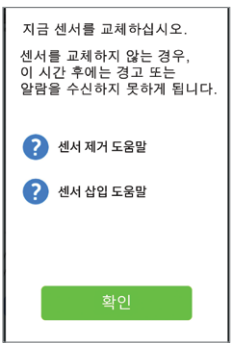

세션이 종료되었습니다.

불가 사항:

- 센서 포도당 수치
- 알람/경고

다음 단계로 가려면 화면의 "?"를 누릅니다.

- 센서 제거
- 새로운 센서를 삽입

세션 중단됨

센서 세션이 중단되었습니다.

- 센서 포도당 수치가 없음
- 새로운 세션을 위한 프롬프트

센서 오류

센서 실패

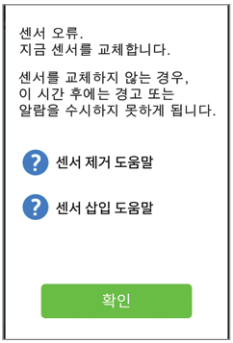

센서 문제가 감지되었습니다.

세션이 자동으로 종료됩니다.

불가 사항:

- 센서 포도당 수치
- 알람/경고

센서를 교체하십시오.

오류

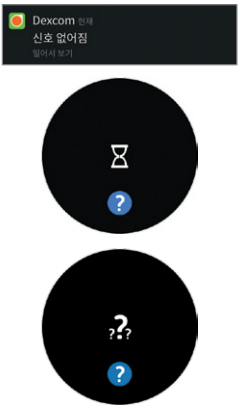

시스템 자동 수정을 하는 동안 최대 3시간 기다립니다.

트랜스미터를 확인합니다. 팟(pod)에 바르게 삽입되었습니까?

파라세타몰/아세트아미노펜을 복용하지 않았는지 확인합니다.

3시간 후에도 수정이 되지 않는 경우 지역 Dexcom 대리점에 문의하십시오.

센서 세션 조기 종료하기

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 일반적인 7일의 센서 세션이 끝나면 자동으로 세션의 종료를 알립니다. 그러나 조기에 세션을 끝낼 필요가 있는 경우, 수동으로 시스템에 센서 세션의 중단을 알려야합니다.

센서 세션을 종료하는 방법을 살펴보겠습니다.

1		**메인 메뉴**를 누릅니다.
2		**센서 중단**을 누릅니다. 센서 세션을 종료합니다. 세션이 가동 중인 경우: • 센서 중단 옵션이 표시됩니다. 세션이 가동 중이 아닌 경우: • 센서 시작 옵션이 표시됩니다.
3		센서 세션이 종료되었음을 확인합니다. 새로운 세션을 시작할 준비가 되었습니다. 1. 센서를 제거합니다. 2. 새로운 센서를 삽입합니다. 3. 새로운 세션을 시작할 준비가 되었으면 녹색 원을 누릅니다.

팟(pod)과 트랜스미터 제거하기

1



센서를 제거할 때가 되면 **지금 센서를 교체하십시오** 화면이 표시됩니다.

3



일회용 밴드(Band-Aid®)처럼 접착제를 피부에서 떼냅니다. 접착제를 떼내면 센서, 팟(pod), 트랜스미터가 모두 제거됩니다.

참고: 모든 구성품을 몸에서 분리하기 전에는 팟(pod)에서 트랜스미터를 제거하지 마십시오.

3



손가락을 사용하여 팟(pod)의 뒤에 있는 탭을 벌립니다.

트랜스미터가 튀어나옵니다.

4

보관

트랜스미터는 다음 센서에 다시 사용할 수 있도록 보관합니다.

5

혈액 접촉 구성품의 폐기에 대한 해당 지역의 지침에 따라 센서를 폐기합니다.

긴급 저혈당 알람

자동 긴급 저혈당 알람은 55mg/dL으로 설정됩니다. 이 알람 또는 이 알람의 재경고 설정을 변경하거나 끌 수 없습니다.

고급 경고

고급 경고는 더 높은 수준에서 포도당을 감지합니다.

기본적으로, 이 경고는 **꺼짐**으로 설정되어 있으나 **켜짐**으로 설정하고 개인 설정을 할 수 있습니다.

상승 속도: 포도당이 급격한 속도(2mg/dL/min) 또는 매우 급격한 속도(3mg/dL/min)로 상승할 경우 장치에 경고가 표시됩니다. 이 기능은 장시간 고혈당 상태가 유지되는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

감소 속도: 포도당이 급격한 속도(-2mg/dL/min) 또는 매우 급격한 속도(-3mg/dL/min)로 감소할 경우 장치에 경고가 표시됩니다. 이 기능은 저혈당 사고를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기본적으로, 다음 경고는 **켜짐**으로 설정되어 있으나 **꺼짐**으로 설정하고 개인 설정을 할 수 있습니다.

신호 없어짐: 센서 포도당 수치를 수신하지 못할 경우 장치에서 경고를 보냅니다. 신호 없어짐 현상은 디스플레이 장치와 트랜스미터의 통신이 중단될 때 발생하므로, 방해물 없이 서로 6미터 내 거리를 유지하십시오.

경고 개인 설정하기

각 포도당 경고에 대해 다음과 같이 할 수 있습니다.

- 경고를 켜거나 끄기
- 경고를 일으키는 값을 변경
- 반복 간격을 설정
- 소리를 변경

낮음 긴급 강한 알람의 소리만 변경할 수 있습니다.

1

메인 메뉴를 누릅니다.

2



경고를 누릅니다.

3

사용자 지정하고자 하는 경고를 누릅니다.

트랜스미터 배터리 종료

새로운 센서 세션을 위한 트랜스미터 준비를 확실히 하려면, 배터리 부족을 알리는 첫 번째 프롬프트가 표시되었을 때 지역 Dexcom 대리점에 연락하여 새 트랜스미터를 주문하는 것이 좋습니다.

	3주 후에 배터리 수명이 종료됩니다.
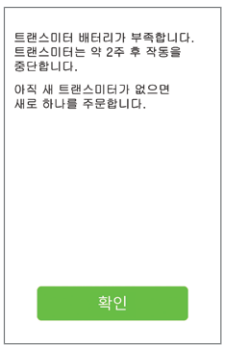	2주 후에 배터리 수명이 종료됩니다. **새 트랜스미터를 주문하십시오.**
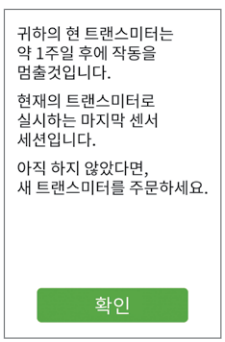	1주일 경고. 사용 중인 트랜스미터로 가동할 수 있는 마지막 센서 세션.

트랜스미터 보증

보장되는 항목 및 보장 기간

Dexcom, Inc. ("Dexcom")은 Dexcom G5 Mobile 트랜스미터가 정상적인 사용 중 재료 및 제조공정상의 결함이 있을 경우 출고일을 기점으로 시작되는 기간 및 해당일 이후 아래와 같이 지속적인 지정 기간("보증 기한")에 최초 구매자에게 제한적 보증을 제공합니다("제한적 보증").

Dexcom G5 Mobile 트랜스미터: **3개월**

참고: 이 트랜스미터를 보증 기간 내에 교체품으로 받은 경우, 원래 트랜스미터의 남은 보증은 이 교체품 트랜스미터로 양도되며, 이 보증 카드는 무효화됩니다.

보장되지 않는 항목

이 제한적 보증은 구매자의 올바른 제품 사용에 따른 조건부입니다. 이 제한적 보증은 다음을 보장하지 않습니다. (a) 사고, 오용, 남용, 부주의, 비정상적인 물리적, 전기적 또는 전기기계적 스트레스, 제품 부분품의 수정 또는 외관 손상, (b) ID 번호가 제거되거나 판독이 불가능해진 장비, (c) 정상적인 사용으로 인해 긁히거나 손상된 모든 표면 및 기타 외부 노출 부분품, (d) Dexcom에서 제공하거나 승인하지 않은 액세서리, 상품 또는 보조/주변 장비와 함께 본 제품을 사용하여 발생한 고장, (e) 잘못된 테스트, 작동, 유지 관리, 설치 또는 조정으로 인한 결함이나 손상, (f) 제품의 설치, 유지 관리 및 서비스, (g) 조립을 분해한 장비, (h) Dexcom G5 Mobile CGM 시스템에 포함되어 있고 dexcom.com에서도 제공되는 Dexcom G5 Mobile 시스템 사용자 가이드에 열거된 사양을 벗어난 범위의 트랜스미터 침수 손상.

제한적 보증에 따른 Dexcom의 의무 사항

Dexcom은 보증 기간 동안 Dexcom의 자유 재량에 따라, 구매자에게 비용을 청구하지 않고 결함 있는 Dexcom G5 Mobile 트랜스미터를 교체해드립니다. 구매자는 배송에 적합한 상자에 제품을 담아 Dexcom 고객 지원 부서에 반품해야 하며 구매일, 제품의 ID 번호, 판매자의 이름 및 주소가 표시된 구매자의 영수증 또는 이에 상응하는 대체 구매 증빙자료를 동봉해야 합니다. Dexcom G5 Mobile 트랜스미터를 배송할 지역에 대해 지원을 받으려면 지역 Dexcom 대리점에 문의하십시오. 제품 수령 시, Dexcom은 결함 있는 제품을 즉시 교체해드립니다. Dexcom의 판단에 따라 제품이 이 제한적 보증에 의해 보장되지 않는 경우, 구매자는 해당 제품의 반환을 위한 모든 배송비를 지불해야 합니다.

Dexcom의 보증 및 법적 책임에 대한 제한

위에 설명한 DEXCOM의 제한적 보증은 독점적이고 사실 또는 법률, 법령이나 다른 방식의 작용에 의한 명시적 또는 묵시적인 모든 다른 보증을 대신하며, DEXCOM은 이러한 모든 다른 보증을 제외하고 부인하며 여기에는 상품성, 특정 목적에의 적합성 또는 비침해성의 보증을 포함하나 이에 국한되지 않습니다. 준거법에서 제한된 범위를 제외하고, DEXCOM은 DEXCOM G5 MOBILE CGM 시스템의 판매, 사용, 오용 또는 사용 불능으로 인해 발생하는 특수한, 부수적인, 결과적 또는 간접적인 피해, 법적 책임 이론에 대해 책임지지 않습니다. 이러한 제한은 DEXCOM 또는 해당 대리인이 이러한 피해에 대해 고지를 받은 경우에도, 그리고 이러한 제한적 구제책의 근본적인 목적을 달성하지 못하는 경우에도 적용됩니다. 이 제한적 보증은 이 제품의 최초 구매자 이외의 다른 이에게 연장되지 않으며 구매자의 독점적 구제책을 명시합니다. 이 제한적 보증의 일부분이라도 법에 저촉되거나 법적 사유로 시행 불가능한 경우, 이러한 부분적 불법성 또는 시행 가능성은 구매자가 승인한 이 제한적 보증의 나머지 부분의 시행 가능성에 영향을 미치지 않으며 항상 약관에 의해 제한되거나 법에서 제한하는 만큼 제한되는 것으로 해석됩니다.

장치 성능 특징

시스템 정확성

CGM 시스템의 정확성은 CGM 포도당 값을 참조 포도당 값과 비교하는 임상 연구1를 통해 평가됩니다. 정확성은 포도당 값이 80mg/dL(4.4mmol/L) 이상(>)이거나, 포도당 값이 20mg/dL(1.1mmol/L), 30mg/dL(1.7mmol/L) 또는 40mg/dL(2.2mmol/L) 이내이거나, 참조 포도당 값이 80mg/dL(4.4mmol/L) 이하일 때 (±) 20%, 30%, 40% 이내에 속하는 CGM 포도당 수치의 비율(%)을 기준으로 합니다. 이 연구에서는 Yellow Springs Instrument 2300 STAT Plus™ Glucose Analyzer(YSI)가 참조 포도당 값으로 사용되었습니다.

YSI의 %20/20, %30/30 또는 %40/40 이내에 속하는 CGM 포도당 수치의 비율(%)

연구	일치한 쌍의 숫자 CGM-YSI	%20/20 (%20/1.1)	%30/30 (%30/1.7)	%40/40 (%40/2.2)
성인 (18세 이상)	2263	93%	98%	99%
소아청소년 (2~17세)	2262	91%	96%	98%

[1]임상 연구 결과에 대한 자세한 내용은 dexcom.com/global을 참조하십시오.

제품 사양

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 가정에서 환자가 사용하도록 고안되었습니다.

이 장비의 제조업체가 지정하거나 제공하지 않은 액세서리 및 변환기를 사용할 경우 전자파 방사가 증가하거나 이 장비의 전자파 내성이 감소할 수 있으며 잘못된 작동을 유발합니다.

트랜스미터 하단의 금속 커넥터를 만지지 마십시오.

본 문서를 통해 Dexcom, Inc.은 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템이 Directive 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. EU 준수 선언서의 전문은 인터넷 주소(dexcom.com/doc)에서 제공됩니다.

센서 제품 사양

포도당 범위	40~400mg/dL
센서 수명	최대 7일
캘리브레이션	상용 혈당계
캘리브레이션 범위	40~400mg/dL
보관 조건	온도: 2°C~25°C 습도: 0%~95% RH
멸균	방사선 멸균

트랜스미터 제품 사양

부분품 번호	9438-06
치수(팟(pod) 포함)	길이: 3.8cm 너비: 2.3cm 두께: 1.3cm
무게(팟(pod) 포함)	11.34g
전원 공급장치	산화은 배터리(교체 불가)
작동 조건	주위 온도: 10°C~42°C 습도: 10%~95% RH
보관 조건	온도: 0°C~45°C 습도: 10%~95% RH
작동 고도	-396.24~4,206미터
제한적 보증	3개월
방수	IP28: 최대 2.4미터에서 24시간 동안 큰 이물질 및 침수로부터 보호. 물 속에서 침수되지 않도록 보호
전기 충격 방지	Type BF Applied Part

트랜스미터 성능 특징

매개변수	성능 특징
TX/RX 주파수	2.402~2.480GHz
대역폭	1.02MHz
최대 정격 출력	1.0mW EIRP
변조	Gaussian 주파수 편이 변조
데이터 속도	1Mbps
데이터 통신 범위	6미터

지침 및 제조업체 적합선언 – 전자파 내성

이 장치는 ESD(일반 정전기) 및 EMI(전자파 간섭) 노출에 대한 내성이 있습니다.

본 트랜스미터(P/N 9438-06)는 다음 표에 지정된 전자파 환경에서 사용하도록 고안되었습니다. 본 트랜스미터의 고객 또는 사용자는 해당 환경에서 제품을 사용해야 합니다.

트랜스미터 전자파 내성 사양

내성 테스트	IEC 60601 테스트 레벨	트랜스미터 준수 레벨	전자파 환경 지침
ESD(정전기 방전) IEC 61000-4-2	± 8kV 접촉 ± 15kV 공중	± 8kV 접촉 ± 15kV 공중	바닥은 나무, 콘크리트 또는 세라믹 타일이어야 합니다. 바닥을 합성 소재로 덮은 경우, 상대 습도는 최소 30%여야 합니다.
상용 주파수 (50/60Hz) 자기장 IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	상용 주파수 자기장은 일반적인 기업 또는 병원 환경 내의 일반적인 장소가 지닌 특징 수준이어야 합니다.
방사형 RF IEC 61000-4-3	80MHz~2700MHz 에서 10V/m (AM 변조)	10V/m	바닥은 나무, 콘크리트 또는 세라믹 타일이어야 합니다. 바닥을 합성 소재로 덮은 경우, 상대 습도는 최소 30%여야 합니다. 권장 이격 거리 $d = 1.2\sqrt{P}$ 150kHz~80MHz $d = 1.2\sqrt{P}$ 80MHz~800MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800MHz~2.5GHz P는 트랜스미터 제조업체에 따른 트랜스미터의 최대 정격 출력 용량을 와트(W)로 나타낸 것이며 d는 권장 이격 거리를 미터(m)로 나타낸 것입니다. 고정 RF 트랜스미터의 전계 강도는 전자파 환경 조사[a]에 규정된 대로 각 주파수 범위[b]의 준수 레벨 이하여야 합니다. 다음 기호가 표시된 장비가 가까이 있을 경우 간섭이 발생할 수 있습니다.

Dexcom G5 Mobile CGM 시스템은 다음 표에 지정된 전자파 환경에서 사용하도록 고안되었습니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템의 고객 또는 사용자는 해당 환경에서 제품을 사용해야 합니다.

전자파 방사 사양

방사 테스트	준수	전자파 환경 지침
RF 방사 CISPR 11	그룹 1	Dexcom G5 Mobile 시스템은 내부 기능에만 RF 에너지를 사용합니다. 따라서, 이 시스템의 RF 방사는 매우 낮으며 전자 장비 근처에서 간섭을 일으킬 확률이 낮습니다.
RF 방사 CISPR 11	Class B	Dexcom G5 Mobile 시스템은 가정용 시설 및 가정용으로 사용되는 건물에 공급되는 공공 저전압 전원 공급망에 직접 연결된 시설을 포함한 모든 시설에 적합합니다.

휴대용 및 모바일 RF 통신 장비와 트랜스미터 간의 권장 이격 거리

본 트랜스미터는 방사형 RF 장애가 제어되는 전자파 환경에서 사용하도록 고안되었습니다. 본 트랜스미터의 고객 또는 사용자는 다음 표에 나와 있는 통신 장비의 최대 정격 출력에 따른 휴대용 및 모바일 RF 통신 장비(트랜스미터/간섭장치)와 CGM 트랜스미터 간의 권장 최소 거리를 유지하면 전자파 간섭을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 휴대폰 및 모바일 RF 장비로는 베이비 모니터, Bluetooth 무선 헤드셋, 무선 라우터, 전자레인지, 내장 Wi-Fi 어댑터가 포함된 노트북, GSM 휴대폰, RFID 스캐너, 보안 경비원이 주로 사용하는 핸드헬드 보안 금속 탐지기가 포함됩니다.

다른 RF 트랜스미터와 Dexcom 트랜스미터 간의 최소 권장 거리

트랜스미터의 최대 정격 출력(W)	트랜스미터의 주파수에 따른 이격 거리(m)		
	150kHz~80MHz $d = 1.2\ P^{½}$	**80MHz~800MHz** $d = 1.2\ P^{½}$	**800MHz~2.5GHz** $d = 2.3\ P^{½}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

표에 나와 있지 않은 최대 정격 출력의 트랜스미터의 경우, 트랜스미터의 주파수에 해당하는 방정식을 사용하여 권장 이격 거리(d)를 미터로 추산할 수 있습니다. P는 트랜스미터 제조업체에 따라 트랜스미터의 최대 정격 출력을 와트(W)로 나타낸 것입니다.

참고 1: *80MHz 및 800MHz의 경우, 더 높은 주파수 범위에 대한 이격 거리가 적용됩니다.*

참고 2: *이러한 지침은 모든 상황에 적용되지 않을 수 있습니다. 전자파 전파는 구조물, 물체, 사람을 통한 흡수와 반사에 의해 영향을 받습니다.*

문제 해결

알람/경고 없음

표시 위치	보이는 이미지	문제	수행할 작업
앱		앱에서 경고가 꺼져 있음	경고 메뉴(메뉴 > 경고)에서 경고가 켜져 있는지 확인합니다. 낮음 긴급 강한 알람은 끌 수 없습니다.
스마트 장치 설정		스마트 장치 설정에서 앱 알림이 꺼져 있음	스마트 장치 설정을 확인하여 Dexcom G5 Mobile 앱이 알림을 보낼 수 있도록 허용합니다. 자세한 내용은 스마트 장치 지침을 참조하십시오.
스마트 장치 설정		방해 금지 모드 설정에 제약이 너무 많음	스마트 장치 설정에서 방해 금지 모드를 끄거나, 예외를 허용하도록 방해 금지 모드 설정을 변경합니다. 자세한 내용은 스마트 장치 지침을 참조하십시오.

센서 포도당 수치

장치	보이는 이미지	문제	수행할 작업
혈중 글루코즈 (BG) 미터		센서 수치와 혈중 글루코즈 (BG) 미터의 값이 동일하게 표시되지 않는 경우가 많음	차이는 종종 발생할 수 있습니다. 서로 다른 체액에서 측정한 수치는 값이 다르게 나타납니다. **미터** - 혈액에서 측정하고 **센서** - 간질액에서 측정합니다. 미터가 80 이하로 표시될 경우 CGM 수치는 ± 20점 이내여야 합니다. 미터가 80 이상으로 표시될 경우 CGM 수치는 ± 20%여야 합니다. 예: 센서 수치가 202mg/dL이고 포도당 미터 값이 188mg/dL인 경우 = 차이는 7%입니다(이는 여전히 정확한 것으로 간주됨). 이러한 지침을 벗어난 경우: **캘리브레이션**을 다시 수행합니다.
앱			
앱		센서 포도당 수치를 구할 수 없음	캘리브레이션을 *하지 마십시오*. 추가 프롬프트를 **기다립니다**. 시스템 문제가 스스로 해결되어 센서 포도당 수치가 계속 제공될 수 있습니다. 최근 센서 수치가 표시된 지 3시간 후: 지역 Dexcom 대리점에 문의하십시오.

앱		센서 포도당 수치를 구할 수 없음	**기다립니다.** 시스템 문제가 스스로 해결되는 경우가 많습니다. 이 문제가 장시간 계속될 경우, 지역 Dexcom 대리점에 문의하여 오류를 보고하십시오.
앱		시스템 디스플레이 장치와 트랜스미터가 통신하지 않음	캘리브레이션을 *하지 마십시오*. 10분 동안 **기다립니다**. *디스플레이 장치*와 *트랜스미터*를 방해물 없고 서로 6미터 이내인 거리로 **옮깁니다**. 다시 10분 동안 **기다립니다**. *스마트 장치*를 **재시동**합니다. 오류가 지속될 경우: 1. 장치의 *Bluetooth 설정*을 **엽니다**. 2. 모든 Dexcom *항목*을 **삭제합니다**. 3. *트랜스미터*를 **페어링**합니다.
앱		센서 포도당 수치가 없음	최대 2시간 동안 **기다립니다.** 초기 캘리브레이션을 할 경우 시스템이 카운트 다운합니다.

어플리케이터

그림	문제	수행할 작업
	안전 잠금 장치를 움직일 수 없음	*안전 잠금 장치*를 똑바로 **당깁니다**. • 몸에서 떨어지게 합니다. • 안전 잠금 장치의 *위쪽 화살표* 방향을 따릅니다.
	어플리케이터 뒤쪽의 버튼(collar)을 올릴 수 없음	어플리케이터 뒤쪽의 버튼(collar)을 올릴 때 힘을 **가합니다**. *흰색* 플런저가 완전히 내려가 어플리케이터 배럴과 맞닿아 있는지 **확인**합니다.
	트랜스미터 래치를 제거할 수 없음	한 번에 잡아 빼지 마십시오. 한 손으로 *팟(pod)*을 **잡습니다**. 다른 손으로 *트랜스미터 래치*를 **비틀어** 트랜스미터 래치를 분리합니다.

팟(Pod) 접착제

그림	문제	수행할 작업
	팟(pod)이 잘 붙지 않음	의료용 테이프(예: Blenderm)를 팟(pod)의 흰색 접착 패치 위에 **붙입니다.** 테이프를 트랜스미터 위에 붙이지 **마십시오.**

하드웨어 오류

장치	보이는 이미지	문제	수행할 작업
앱		*Bluetooth* 없음	스마트 장치의 설정으로 **이동합니다.** *Bluetooth*가 켜져 있는지 **확인합니다**. 문제가 지속될 경우 장치 제조업체에 문의하십시오.
혈중 글루코즈 (BG) 미터		40~400mg/dL 범위를 벗어나면 시스템이 캘리브레이션을 수용하지 않음	포도당 범위가 40~400mg/dL이 될 때까지 **기다립니다.** 혈중 글루코즈(BG) 측정값이 40~400mg/dL이 되었을 때만 **캘리브레이션합니다.**
앱		시스템이 캘리브레이션을 수용하지 않음(센서 포도당 수치 문제 해결에서 가능한 이유 참조) 오류가 해결되기 전까지는 센서 포도당 수치가 표시되지 않음	15분 동안 **기다립니다.** 캘리브레이션 1을 **입력합니다**. 오류 화면이 계속 표시되면 혈중 글루코즈(BG) 측정값 1을 추가로 입력합니다. 15분 동안 **기다립니다**. 센서 포도당 수치가 디스플레이에 표시되지 않으면 센서를 교체해야 합니다. 지역 Dexcom 대리점에 문의하여 오류를 보고하십시오. 같은 지침을 따릅니다. 자세한 내용을 보려면 *물음표*를 **누르십시오**.

앱		시스템이 캘리브레이션을 수용하지 않음	15분 동안 **기다립니다.** 혈중 글루코즈(BG) 측정값 1을 **입력합니다.** 15분 동안 기다립니다. 오류 화면이 계속 표시되면 혈중 글루코즈(BG) 측정값 1을 추가로 입력합니다. 15분 동안 기다립니다. 센서 포도당 수치가 디스플레이에 표시되지 않으면 센서를 교체해야 합니다. 지역 Dexcom 대리점에 문의하십시오.
앱		트랜스미터가 작동하지 않음 센서 세션이 자동으로 중단됨 센서 포도당 수치가 표시되지 않음	지역 Dexcom 대리점에 **문의하십시오**. 혈중 글루코즈(BG) 미터를 사용하여 BG값 **확인을 시작합니다**. 경고를 지우려면 *확인*을 **누릅니다**. 지워진 경고는 다시 표시되지 않습니다. 새 트랜스미터를 **주문합니다**.
앱		페어링 실패	앱의 트랜스미터 일련번호가 정확한지 확인합니다. 잘못된 경우: 센서 세션을 **중단합니다.** 올바른 트랜스미터 일련번호를 **다시 입력합니다**. 메뉴 > 트랜스미터 일련번호 > 올바른 일련번호 **입력** 정확한 경우: 지역 Dexcom 대리점에 **문의하십시오.**

앱		트랜스미터 배터리 잔량 낮음	경고를 지우려면 *확인*을 **누릅니다**. 지워진 경고는 다시 표시되지 않습니다. 새 트랜스미터를 **주문합니다**.

패키지 라벨의 기호

다음 기호는 센서 및 트랜스미터 패키지 라벨에서 볼 수 있습니다. 이러한 기호는 Dexcom G5 Mobile 시스템의 올바르고 안전한 사용에 대한 정보를 알려줍니다.

이러한 일부 기호는 해당 지역에서는 의미가 같지 않을 수 있으며, 정보 제공을 위해서만 나열된 것입니다. 이 표에는 각 기호의 의미가 나와 있습니다.

	유효 기간		배치/로트 번호
	주의		부분품/카탈로그 번호
	제조일		방사선 멸균
	재사용 금지		온도 제한
	일련번호		IP28: 큰 이물질 및 침수로부터 보호
	클래스 II 장비		IP22: 큰 이물질 및 떨어지는 물방울로부터 보호
	교류		직류
	BF형 장착부		유럽 대리인
	제조업체		비전이성 방사선
	제한 습도		포장이 손상되었을 경우 사용 금지

	European Union WEEE Directive 2012/19/EU	**SB**	배송일
	주로 실내용으로 설계된 전기 장비		*Bluetooth*
	입력		사용 설명서/소책자 참조
	건조한 상태 유지		

용어 해설

A1C	1형 당뇨병 또는 2형 당뇨병을 진단하고 당뇨병을 얼마나 잘 관리하고 있는지 측정하는 데 사용되는 혈액 검사입니다. A1c 검사 결과는 지난 2~3개월간의 평균 혈당 수준을 반영합니다.
IP	IEC(International Electrotechnical Commission)는 전자제품의 안전 기준을 만들기 위해 설립된 비영리 국제 비정부 기구입니다. 이 기구에서 고안한 안전 기준 중 하나가 IP(Ingress Protection) 표시이며, 이는 먼지, 수분, 우발성 접촉 등으로부터 전자 장치가 얼마나 잘 보호되는지 분류하고 등급을 산정합니다. IP 등급은 전자 장치에 발생하는 상황을 기준으로 한 숫자가 포함된 수치로 표시합니다.
RF	트랜스미터에서 스마트 장치로 포도당 정보를 전송하는 데 사용되는 무선 주파수 전송입니다.
mg/dL	데시리터당 밀리그램. 혈당 레벨을 측정하는 국제 표준 단위입니다.
경고	다음 기능에 중요한 위험 정보가 있다는 사실을 알려 주는 안전에 관한 설명입니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 사용으로 인한 심각하거나 생명을 위협할 수 있는 상황, 결과, 위험을 피하는 방법을 설명합니다.
고혈당	혈당이 높은 것입니다. "높음" 또는 높은 혈당과 같습니다. 고혈당은 혈류에 포도당이 과도하게 많은 것이 특징입니다. 고혈당을 치료하는 것은 중요합니다. 치료하지 않고 방치할 경우, 고혈당은 심각한 합병증으로 이어질 수 있습니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템에서 높음 경고의 기본 설정값은 200mg/dL으로 설정되어 있습니다. 귀하에게 적합한 고혈당 기준 설정을 결정하려면 의료전문가와 상담하십시오.
금기	Dexcom G5 Mobile을 사용할 경우 해로울 수 있으므로 사용해서는 안 되는 특정한 상황을 요약한 안전에 관한 설명입니다. 잠재적인 이점보다 사용 위험이 더 큽니다.

대체 부위 검사	손바닥, 팔뚝 또는 상완 같은 손가락 이외의 (대체) 부위에서 채혈한 혈액 샘플을 미터 수치에 사용하는 방법입니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 캘리브레이션할 경우에는 대체 부위 검사를 사용하지 말고 손가락 채혈 측정만 사용하십시오.
사용 전 주의사항	귀하 또는 의료전문가가 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 안전하고 효과적으로 사용하기 위한 특수 조치의 안전에 관한 설명입니다.
센서 세션	새 센서를 삽입한 후 7일간 실행되는 모니터링 기간입니다. 이 기간에는 포도당을 모니터링하고 5분마다 보고하며, 데이터를 앱으로 전송합니다.
수직	스마트 장치가 세로 방향인 상태입니다.
수평	스마트 장치가 가로 방향인 상태입니다.
스마트/모바일 장치	스마트/모바일 장치는 (충전하고 있지 않은 한) 선이 없는 전자 장치, (쉽게 운반할 수 있는) 모바일 장치, (Wi-Fi, 3G, 4G 등을 통해) 연결되어 있고 어느 정도 독자적으로 작동하는 전자 장치입니다. 스마트/모바일 장치의 예로는 스마트폰과 태블릿이 있습니다.
앱	특정한 용도에 부합하도록 설계된 단독 프로그램 또는 소프트웨어 요소로, 애플리케이션은 특히 사용자가 스마트 또는 모바일 장치에 다운로드하게 됩니다. Dexcom G5 Mobile 앱은 연속적인 포도당 모니터링을 위한 디스플레이로 개발되었습니다.
연속적인 포도당 모니터링(CGM) 시스템	연속적인 포도당 모니터링(CGM) 시스템은 피하에 삽입된 센서를 사용하여 간질액 내의 포도당 레벨을 확인합니다. 트랜스미터는 센서 포도당 수치를 Dexcom 앱에 전송합니다.
인슐린 축적	이전 투여 직후 인슐린 투여를 추가로 주입하는 경우입니다. 이는 저혈당으로 이어질 수 있습니다.

저혈당	혈당이 낮은 것입니다. "낮음" 또는 낮은 혈당과 같습니다. 저혈당은 혈류 내의 포도당 레벨이 낮은 것이 특징입니다. 저혈당을 치료하는 것은 중요합니다. 치료하지 않고 방치할 경우, 저혈당은 심각한 합병증으로 이어질 수 있습니다. Dexcom G5 Mobile CGM 시스템에서 낮음 경고의 기본값은 80mg/dL으로 설정되어 있습니다. 귀하에게 적합한 저혈당 기준 설정을 결정하려면 의료전문가와 상담하십시오.
적응증	특정한 치료 또는 절차를 권장할 만한 상태입니다. 목적과 상황에 따른 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템 사용 방법입니다. 누가 그리고 언제 Dexcom G5 Mobile CGM 시스템을 사용해야 하는지 알려줍니다.
캘리브레이션	캘리브레이션은 미터의 손가락 채혈 BG값과 센서의 간질액 포도당 수치를 서로 비교하거나 측정하는 것입니다. 혈액과 간질액은 유사하지만, 혈액 속의 포도당 농도가 더 높습니다. 캘리브레이션을 사용하면 센서와 미터 수치 사이의 정렬을 맞출 수 있습니다. 캘리브레이션을 할 경우, 미터로 손가락 채혈 혈당을 측정한 다음 스마트 장치에 값을 입력합니다. 시스템은 이 값을 사용하여 센서 포도당 수치가 올바른 상태인지 확인합니다.
탈옥	스마트 장치에 제조업체가 설정한 제한 사항 및 보안 조치를 제거하는 것입니다. 이를 제거할 경우 보안 위험을 야기하며 데이터가 취약해집니다. 탈옥한 스마트 장치에서 Dexcom G5 Mobile 앱을 사용, 설치하거나 실행하지 마십시오. 탈옥한 스마트 장치에서는 앱이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
혈당계/미터/혈중 글루코즈(BG) 미터	혈당계는 혈중 포도당 양을 측정하기 위해 사용하는 의료 장치입니다.
혈중 글루코즈(BG) 값	BG는 blood glucose의 줄임말입니다. 혈당값은 혈중 글루코즈(BG) 미터로 측정한 혈중 포도당의 양입니다.

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
미국 외: 해당 지역 Dexcom
대리점에 문의하십시오.
수허18-212호

LBL016009 Rev 003 MT25405
Rev Date 2020/05

© 2020 Dexcom, Inc. All rights reserved.
Dexcom, Dexcom Follow, Dexcom G5, Dexcom G5 Mobile 및 Dexcom Share는 미국 및/또는 기타 국가에서 Dexcom, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Dexcom